



GlideScope® und GlideRite®  
Kompatible Aufbereitungsprodukte

GlideScope®  
verathon



# GlideScope® und GlideRite® Kompatible Aufbereitungsprodukte

Gültig ab: 27. Februar 2025

Vorsicht: In den Vereinigten Staaten ist dieses Gerät per Bundesgesetz auf den Verkauf durch einen Arzt oder auf dessen Anweisung beschränkt.

# Kontakt Daten

Weitere Informationen zu Ihrem GlideScope-System erhalten Sie vom Verathon-Kundendienst oder unter [verathon.com/service-and-support](http://verathon.com/service-and-support).

## **Verathon Inc.**

20001 North Creek Parkway  
Bothell, WA 98011 U.S.A.  
Tel: +1 800 331 2313 (nur USA und Kanada)  
Tel: +1 425 867 1348  
Fax: +1 425 883 2896  
[verathon.com](http://verathon.com)



## **Verathon Medical (Canada) ULC**

2227 Douglas Road  
Burnaby, BC V5C 5A9  
Kanada  
Tel.: +1 604 439 3009  
Fax: +1 604 439 3039



## **Verathon Medical (Europe) B.V.**

Willem Fenengastraat 13  
1096 BL Amsterdam  
Niederlande  
Tel.: +31 (0) 20 210 30 91  
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

## **Verathon Medical (Australien) Pty Limited**

Unit 9, 39 Herbert Street  
St Leonards NSW 2065  
Australien

In Australien: 1800 613 603 Tel / 1800 657 970 Fax  
International: +61 2 9431 2000 Tel /  
+61 2 9475 1201 Fax



## **MDSS CH GmbH**

Laurenzenvorstadt 61  
5000 Aarau  
Schweiz



CH

## **Anandic Medical Systems AG**

Stadtweg 24  
8245 Feuerthalen  
Schweiz



Copyright © 2025, von Verathon Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne die vorherige Genehmigung durch Verathon Inc. weder ganz noch in Auszügen in irgendeiner Weise kopiert oder übertragen werden.

GlideScope, GlideScope Core, GlideScope Go, Spectrum, AVL, BFlex, GlideRite, Verathon und zugehörige Symbole sind Marken von Verathon Inc. Alle weiteren Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Nicht alle in diesem Dokument dargestellten oder beschriebenen Produkte von Verathon Inc. sind in allen Ländern im Handel erhältlich.

Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellsten Informationen finden Sie in der Dokumentation unter [verathon.com/service-and-support](http://verathon.com/service-and-support).

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>WICHTIGE INFORMATIONEN</b> .....	<b>1</b>
Einführende Informationen.....	1
In diesem Dokument behandelte Produkte.....	2
<b>KOMPATIBILITÄTS- UND WIRKSAMKEITSTABELLEN</b> .....	<b>8</b>
AVL Video Batons.....	9
Video Baton 2.0.....	11
Video Baton QC.....	12
Videolaryngoskope und Mandrins.....	13
GlideScope Core-Monitore, Workstation und Netzteil.....	16
GlideScope Go 2-Monitor und Ladestation.....	18
GlideScope Go-Monitor und Ladestation.....	19
GlideScope-Videomonitor, mobiles Stativ, Premium Cart und Netzteil.....	20
Kabel für GlideScope Core-Monitore.....	21
Kabel für GlideScope-Videomonitor.....	23
<b>GLOSSAR</b> .....	<b>26</b>



# Wichtige Informationen

---

## Einführende Informationen

Die Reinigung und Desinfektion ist ein wesentlicher Bestandteil der Verwendung und Wartung wiederverwendbarer Komponenten. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass alle wiederverwendbaren Systemkomponenten gemäß der Anleitung im *Aufbereitungshandbuch für GlideScope- und GlideRite-Produkte* gereinigt und bei Bedarf desinfiziert oder sterilisiert wurden. Auch sollten Sie das GlideScope-System in regelmäßigen Abständen überprüfen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Bedienungs- und Wartungshandbuch.


Begriffsdefinitionen und weitere Informationen zu Standards für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation finden Sie auf der Seite „Disinfection and Sterilization“ der United States Centers for Disease Control and Prevention (<http://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/index.html>).

Die Verfügbarkeit und rechtliche Konformität der in diesem Dokument genannten Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsprodukte hängen von der jeweiligen Region ab. Wählen Sie Produkte aus, die den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsprechen.

# In diesem Dokument behandelte Produkte

Dieses Dokument enthält eine Aufstellung von Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsmitteln für ein breites Spektrum von GlideScope- und GlideRite-Produkten. Beachten Sie bitte auch die folgenden Bilder, die Ihnen helfen, die Komponente zu bestimmen, die Sie aufbereiten.

## AVL Video Batons

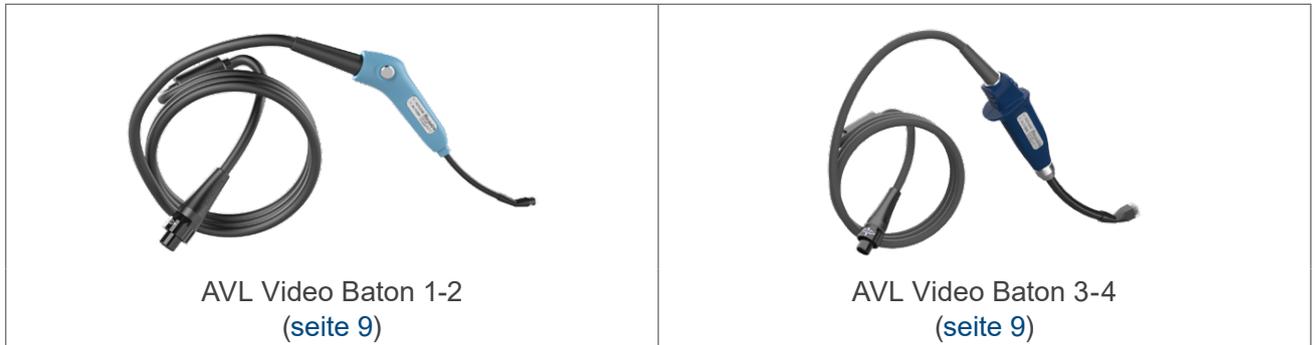

## Video Baton 2.0



## Video Baton QC




# Videolaryngoskope und Mandrins

 <p>LoPro T2 (seite 13)</p>	 <p>LoPro T3 (seite 13)</p>	 <p>LoPro T4 (seite 13)</p>
 <p>MAC T3 (seite 13)</p>	 <p>MAC T4 (seite 13)</p>	
 <p>Starrer GlideRite-Mandrin (seite 13)</p>	 <p>GlideRite DLT-Mandrin (seite 13)</p>	

# GlideScope Core-Monitore, Workstation und Netzteil



GlideScope Core 15- und Core 15 FHD-Monitore  
(seite 16)

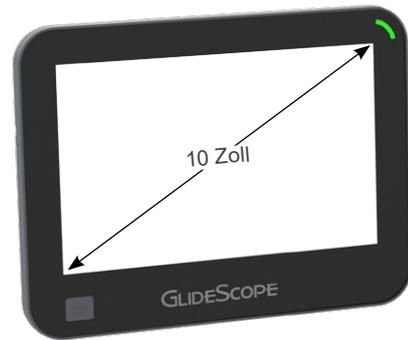

GlideScope Core 10- und Core 10 FHD-Monitore  
(seite 16)



GlideScope Core Premium Workstation  
(seite 16)



GlideScope Core-Netzteil (seite 16)

## GlideScope Go 2-Monitor und Ladestation



## GlideScope Go-Monitor und Ladestation



## GlideScope-Videomonitor, mobiles Stativ, Premium Cart und Netzteil



GlideScope-Videomonitor  
(seite 20)



GlideScope-Videomonitor-Netzteil  
(seite 20)




GlideScope-Videomonitor Premium Cart  
(seite 20)




GlideScope-Videomonitor mobiles Stativ  
(seite 20)

## Kabel für GlideScope Core-Monitore

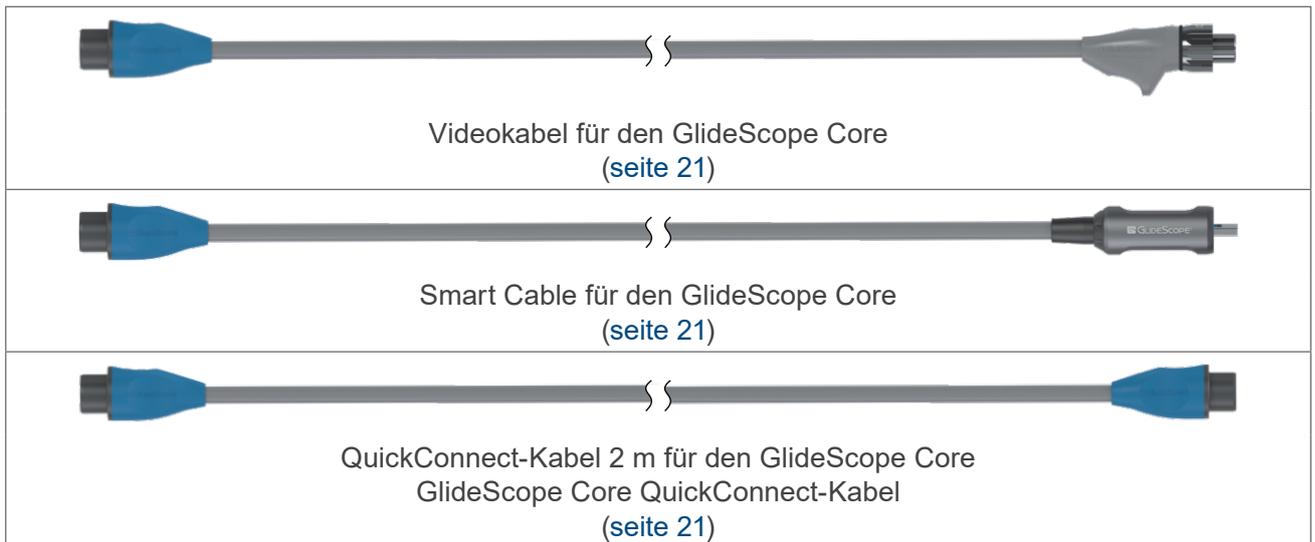

Hinweise: Die Kabel sind verkürzt dargestellt.

## Kabel für GlideScope-Videomonitor

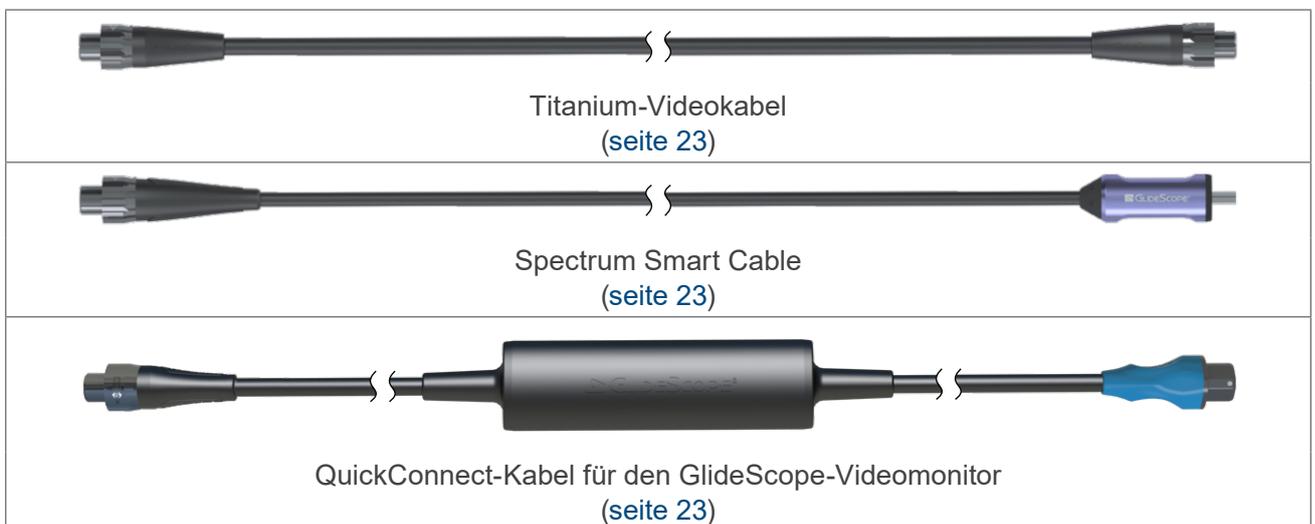

# Kompatibilitäts- und Wirksamkeitstabellen

## WICHTIG

Wenn in den folgenden Tabellen ein Produkt für die GlideScope- oder GlideRite-Komponente, die Sie reinigen, desinfizieren oder sterilisieren, als wirksam aufgeführt ist, beachten Sie die spezifischen Anweisungen im *Aufbereitungshandbuch für GlideScope- und GlideRite-Produkte*. Die Konzentrationen, Temperaturen, Zeiten und spezifischen Anweisungen in diesem Handbuch basieren auf von Verathon durchgeführten Tests und können von den Herstelleranweisungen für bestimmte Aufbereitungsprodukte abweichen.

In den Tabellen in diesem Dokument sind die Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsprodukte aufgeführt, die Verathon mit seinen Systemkomponenten geprüft hat, um ihre Kompatibilität, Wirksamkeit oder beides zu beurteilen. Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutungen der Kompatibilitäts- und Wirksamkeitsindikatoren in den Tabellen.

INDIKATOR	BEDEUTUNG
●	Dieses Produkt ist sowohl mit dieser Komponente kompatibel als auch dafür wirksam.
○	Dieses Produkt ist mit dieser Komponente kompatibel, Verathon hat seine Wirksamkeit jedoch nicht bestimmt. Hinweise zur Wirksamkeit entnehmen Sie bitte den Herstelleranweisungen.
(Anzahl)	Dieses Produkt ist mit dieser Komponente bis zu der in Klammern angegebenen Anzahl von Verwendungszyklen kompatibel. Als kompatibel aufgeführte Produkte, bei denen diese Anzahl nicht angegeben ist, sind bis zu der oben in der Tabelle angegebenen Standardanzahl von Verwendungszyklen kompatibel.

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Indikatoren und andere Informationen in den Tabellen angeordnet sind.

PRODUCT	DISINFECTION LEVEL	Verathon-Systemkomponenten		
		TITANIUM BLADE (LOPRO T2)	TITANIUM BLADE (ALL OTHERS)	GLIDERITE REUSABLE STYLET
Default Compatibility (Cycles)		3000	3000	3000
Metrex CaviWipes1	Cleaning / Low		○	○
PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipes	Cleaning / Low	○	○	○
schülke gigasept PAA concentrate	Low			○
ASP CIDEX Activated Dialdehyde Solution (ADS)	High	● (1000)	● (1000)	

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

# AVL Video Batons

PRODUKT	DESINFEKTIONS- STUFE	AVL VIDEO BATON 1-2	AVL VIDEO BATON 3-4
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>
STERIS PRE-Klenz Gel für den Instrumententransport	Vorreinigung		○
Anios Aniosyme XL3 enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen		○
Dr. Weigert neodisher MediClean forte	Reinigen		○
Ecolab enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen		○
Ecolab Incidin Dry Wipes System (die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen		○
Ecolab MetalClean Plus	Reinigen		○
Isopropylalkohol (IPA; 70 %; allgemeine Desinfektionstücher, die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen		○
schülke thermosept ER Reiniger	Reinigen		○
STERIS Prolystica 2× enzymatisches Konzentrat zum Voreinweichen und Reinigen	Reinigen	●	●
B. Braun Meliseptol HBV Tücher	Reinigung/Niedrig		○
Clinell Universaltücher	Reinigung/Niedrig	○	○
Dr. Schumacher DESCOSEPT SENSITIVE WIPES	Reinigung/Niedrig		○
Metrex CaviWipes1	Reinigung/Niedrig	○	○
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig		●
PDI Sani-Cloth Bleach keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	○	○
PDI Super Sani-Cloth keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig		○
Diversey Accel INTERvention Feuchttücher	Niedrig	○ (1100)	○ (1100)
Diversey Oxivir Tb Feuchttücher	Niedrig	○ (1100)	○ (1100)
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoch		○
ASP CIDEX OPA Desinfektionsmittel	Hoch		○
ASP CIDEX PLUS	Hoch		○
Cantel (MEDIVATORS) Advantage Plus Endoskopaufbereitungssystem (unter Verwendung von Cantel Rapticide PA 30°C)	Hoch		● (100)
Metrex MetriCide Plus 30	Hoch		○
Sultan Healthcare Sporox II	Hoch		○ (500)

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	AVL VIDEO BATON 1-2	AVL VIDEO BATON 3-4
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>
Anios Anioxyde 1000 hochwirksames Desinfektionsmittel und Kaltsterilisationsmittel	Hoch/Sterilisation	○ (1200)	○
STERIS V-PRO Niedertemperatur-Sterilisationssysteme (V-PRO 1, V-PRO 1 Plus, V-PRO maX, V-PRO 60; alle unter Verwendung von STERIS VAPROX HC)	Sterilisation		○ (200)
STERRAD 50 STERRAD 200S (Kurz- und Standardzyklen) STERRAD 100S (Kurzzyklen für die USA und andere Regionen) STERRAD NX (Standardzyklus) STERRAD 100 NX (Standardzyklus) Alle unter Verwendung von Hydrogenperoxidgas-Plasma	Sterilisation		○ (100)

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

## Video Baton 2.0

PRODUKT	DESINFEKTIONSSTUFE	VIDEO BATON 2.0 GROSS (3-4)
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>2000</b>
ASP CIDEZYME/ENZOL enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	○
Dr. Weigert neodisher MediClean forte	Reinigen	○
Ecolab enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	○
Ecolab Incidin Dry Wipes System (die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○
HARTMANN Bacillol 30 Tissues	Reinigen	○
Isopropylalkohol (IPA; 70 %; allgemeine Desinfektionstücher, die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○
Metrex EmPower	Reinigen	○
schülke perform (pulverförmiges Konzentrat)	Reinigen	○
schülke thermosept ER Reiniger	Reinigen	○
STERIS Prolystica 2x enzymatisches Konzentrat zum Voreinweichen und Reinigen	Reinigen	●
B. Braun Meliseptol HBV Tücher	Reinigung/Niedrig	○
Clinell Universaltücher	Reinigung/Niedrig	○
Dr. Schumacher DESCOSEPT SENSITIVE WIPES	Reinigung/Niedrig	○
Metrex CaviWipes1	Reinigung/Niedrig	○
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	●
PDI Super Sani-Cloth keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	○
Vernacare TUFFIE 5 Universalreinigungstücher	Reinigung/Niedrig	○
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoch	○
ASP CIDEX OPA Desinfektionsmittel	Hoch	○
ASP CIDEX PLUS	Hoch	○ (500)
Metrex MetriCide Plus 30	Hoch	○ (500)
Sultan Healthcare Sporox II	Hoch	○ (500)
Anios Anioxyde 1000 hochwirksames Desinfektionsmittel und Kaltsterilisationsmittel	Hoch/Sterilisation	○
STERIS V-PRO Niedertemperatur-Sterilisationssysteme (V-PRO 1, V-PRO 1 Plus, V-PRO maX, V-PRO 60; alle unter Verwendung von STERIS VAPROX HC)	Sterilisation	○ (200)
STERRAD 50 STERRAD 200S (Kurz- und Standardzyklen) STERRAD 100S (Kurzzyklen für die USA und andere Regionen) STERRAD NX (Standardzyklus) STERRAD 100 NX (Standardzyklus) Alle unter Verwendung von Hydrogenperoxidgas-Plasma	Sterilisation	○ (100)

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

# Video Baton QC

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	VIDEO BATON QC GROSS
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>2000</b>
ASP CIDEZYME/ENZOL enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	○
PDI Sani-Cloth Plus keimtötende Feuchttücher	Reinigen	○
STERIS Prolystica 2x enzymatisches Konzentrat zum Voreinweichen und Reinigen	Reinigen	●
Clinell Universaltücher	Reinigung/Niedrig	○
Metrex CaviWipes	Reinigung/Niedrig	○
Metrex CaviWipes1	Reinigung/Niedrig	○
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	●
PDI Sani-Cloth Prime keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	○
PDI Super Sani-Cloth keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	○
Vernacare TUFFIE 5 Universalreinigungstücher	Reinigung/Niedrig	○
WIP'ANIOS EXCEL	Reinigung/Niedrig	○
schülke mikrocid sensitive wipes	Niedrig	○
Tristel Trio Feuchttuchsystem	Reinigung/hoch	○
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoch	○
ASP CIDEX OPA Desinfektionsmittel	Hoch	○

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

# Videolaryngoskope und Mandrins

PRODUKT	DESINFEKTIONSSTUFE	TITANIUM-SPATEL	WIEDERVERWENDBARER GLIDERITE-MANDRIN
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>
Covidien FRED Anti-Fog Solution	Antibeschlag	○ (100)	
Covidien FRED Lite Anti-Fog Solution	Antibeschlag	○ (100)	
BeliMed Protect enzymatisches Vorbehandlungs-Schaumspray	Vorreinigung	○	○
Ecolab OptiPro Gel-Vorreiniger für Instrumente	Vorreinigung	○	○
STERIS PRE-Klenz Gel für den Instrumententransport	Vorreinigung	○	○
Anios Aniosyme XL3 enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	○	○
Certol ProEZ Foam enzymatisches Spray	Reinigen	○ (500)	○ (500)
Dr. Weigert neodisher MediClean forte	Reinigen	○	○
Ecolab enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	○	○
Ecolab Incidin Dry Wipes System (die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○ (1500)
Ecolab MetalClean Plus	Reinigen	○	○
Ecolab OptiPro multienzymatisches Reinigungsmittel mit niedriger Schaumbildung	Reinigen	●	●
Ecolab Sekusept MultiEnzyme	Reinigen	○	
Getinge Renuzyme Schaumspray	Reinigen	○	○
Getinge Tec Wash III	Reinigen	●	● (1500)
HARTMANN Bodedex forte	Reinigen	○	
Isopropylalkohol (IPA; 70 %; allgemeine Desinfektionstücher, die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○ (1500)
Metrex CaviCide	Reinigen	●	● (1500)
Metrex EmPower	Reinigen	●	● (1500)
Pro-Line Solutions EcoZyme	Reinigen	●	● (1500)
Ruhof Endozime AW Plus	Reinigen	○	○
Ruhof Endozime AW Triple Plus mit APA	Reinigen	○	○
Ruhof Endozime Bio-Clean	Reinigen	○	○
Ruhof Endozime Premium mit APA	Reinigen	○	○
Ruhof Liquidclean AW	Reinigen	○	○

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	TITANIUM-SPATEL	WIEDERVERWENDBARER GLIDERITE-MANDRIN
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>
Ruhof Prepzyme	Reinigen	○	○ (1500)
STERIS eSEENTIALS Konzentrate	Reinigen	●	
schülke gigazyme X-tra	Reinigen		○
schülke thermosept ER Reiniger	Reinigen	○	○
Natriumdodecylsulfat (NDS)-Lösung	Reinigen	○ (100)	
STERIS Prolystica 2× enzymatisches Konzentrat zum Voreinweichen und Reinigen	Reinigen	●	●
Clinell Universaltücher	Reinigung/Niedrig	○	○
Ecolab Sekusept PLUS	Reinigung/Niedrig		○
Metrex CaviWipes1	Reinigung/Niedrig	○	○
PDI Sani-Cloth Bleach keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig		○
PDI Super Sani-Cloth keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	○	○
Tristel Trio Feuchttuchsystem	Reinigung/hoch	●	○
ASP CIDEX Activated Dialdehyde Solution (ADS)	Hoch	● (1000)	
ASP CIDEX OPA Desinfektionsmittel	Hoch	●	●
ASP CIDEX PLUS	Hoch	●	○ (200)
Cantel (MEDIVATORS) Advantage Plus Endoskopaufbereitungssystem, unter Verwendung von Rapicide PA 30°C	Hoch	● (100)	● (100)
Cantel (MEDIVATORS) automatisierte Endoskopaufbereiter: CER Optima 1 & 2 DSD-201 SSD-102	Hoch	● (100)	
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide OPA/28	Hoch	●	
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoch	●	●
Gioperacetic Desinfektionslösung	Hoch	○	
HARTMANN Korsorex extra	Hoch	○	
LANXESS Rely+On PeraSafe	Hoch	○	
Metrex Metricide 28	Hoch	●	● (1500)
Metrex MetriCide OPA Plus	Hoch	●	●
Metrex MetriCide Plus 30	Hoch	●	○ (200)
schülke gigasept PAA concentrate	Hoch		○

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

PRODUKT	DESINFEKTIONSSTUFE	TITANIUMSPATEL	WIEDERVERWENDBARER GLIDERITEMANDRIN
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>
STERIS Resert XL HLD	Hoch	●	● (1500)
STERIS Revital-Ox Resert XL HLD	Hoch	●	● (1500)
STERIS Revital-Ox Resert XL HLD / Chemosterilans	Hoch	●	● (1500)
Sultan Healthcare Sporox II	Hoch		○ (200)
Thermische Desinfektion (Reinigungs- und Desinfektionssysteme, 90 °C für 5 min oder 93 °C für 2,5 min; nur EU)	Hoch		● (100)
Tristel Duo Schaum-Wischtücher	Hoch	○ (500)	○ (500)
Anios Anioxyde 1000 hochwirksames Desinfektionsmittel und Kaltsterilisationsmittel	Hoch/Sterilisation	○	○
STERIS S40 oder S20 in einem der folgenden Systeme: System 1 E System 1 System 1 Express System 1 Plus	Hoch/Sterilisation	● (650)	● (500)
Autoklav (Dampfzyklus, 132 bis 134 °C)	Sterilisation		● (300)
Autoklav (Dampfzyklus, 137 °C)	Sterilisation		○ (300)
Ethylenoxid (EO)	Sterilisation	● (100)	● (100)
STERIS V-PRO Niedertemperatur-Sterilisationssysteme: V-PRO 1 V-PRO 1 Plus V-PRO maX V-PRO 60 Alle unter Verwendung von STERIS VAPROX HC	Sterilisation	● (125)	● (500)
STERRAD 50 STERRAD 200S (Kurz- und Standardzyklen) STERRAD 100S (Kurzzyklen für die USA und andere Regionen) STERRAD NX (Standardzyklus) STERRAD 100 NX (Standardzyklus) Alle unter Verwendung von Hydrogenperoxidgas-Plasma	Sterilisation	● (300)	● (500)

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

# GlideScope Core-Monitore, Workstation und Netzteil

PRODUKT	DESINFIZIERUNGSSTUFE	GLIDESCOPE CORE 15- UND CORE 15 FHD-MONITORE	GLIDESCOPE CORE 10- UND CORE 10 FHD-MONITORE	PREMIUM-WORKSTATION	BATON-HALTEKLAMMER	STANGEN-KLEMMENSATZ	NETZTEIL	BFLEX 2-HALTER	HALTER FÜR AVL VIDEO BATON
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2000</b>
Ecolab Incidin Dry Wipes System (die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○	○	○	○	○		
HARTMANN Bacillol 30 Tissues	Reinigen	○	○	○					
Isopropylalkohol (IPA; 70 %; allgemeine Desinfektionstücher, die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○	○	○	○	○	○	
Metrex CaviWipes	Reinigen	○	○	○					
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Reinigen	○	○	○		○			
PDI Sani-Cloth Plus keimtötende Feuchttücher	Reinigen	○	○	○					○
schülke perform (pulverförmiges Konzentrat)	Reinigen	○	○	○					
Natriumhypochlorit (Bleichmittel; 0,16 %, 1.600 ppm; mit Wischtüchern aufgetragen)	Reinigen			○	○				
Clinell Universaltücher	Reinigung/ Niedrig	○	○	○		○	○		
Diversey Accel Five TB	Reinigung/ Niedrig				○				
Metrex CaviWipes	Reinigung/ Niedrig				○				

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

PRODUKT	DESINFEKTIONS- STUFE	GLIDESCOPE CORE 15- UND MONITORE	GLIDESCOPE CORE 10- UND MONITORE	PREMIUM- WORKSTATION	BATON- HALTEKLAMMER	STANGEN- KLEMMENSATZ	NETZTEIL	BFLEX 2- HALTER	HALTER FÜR AVL VIDEO BATON
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2000</b>
Metrex CaviWipes1	Reinigung/ Niedrig	○	○	○		○			
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Reinigung/ Niedrig			○		○			
PDI Sani-Cloth Prime	Reinigung/ Niedrig	○	○	○					
PDI Super Sani-Cloth keimtötende Feuchttücher	Reinigung/ Niedrig	○	○	○	○	○			
Vernacare TUFFIE 5 Universalreini- gungstücher	Reinigung/ Niedrig	○	○						
Virox Technologies Accel TB Feuchttücher	Reinigung/ Niedrig			○					
Diversey Accel INTERVention Feuchttücher / Diversey Oxivir Tb Feuchttücher	Niedrig		○	○	○				

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

## GlideScope Go 2-Monitor und Ladestation

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	GLIDESCOPE GO 2-MONITOR	LADESTATION	NETZTEILE
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
ASP CIDEZYME/ENZOL enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	●	○ <sup>1</sup>	
Ecolab Incidin Dry Wipes System (die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○	
Isopropylalkohol (IPA; 70 %; allgemeine Desinfektionstücher, die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○	
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Reinigen	○	○	
Clinell Universaltücher	Reinigung/Niedrig	○	○	○
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Niedrig	○	○	
ASP CIDEX OPA Desinfektionsmittel	Hoch	○		
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoch	○		

<sup>1</sup> Nur kompatibel, wenn feuchte Tücher verwendet werden.

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

## GlideScope Go-Monitor und Ladestation

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	GLIDESCOPE GO-MONITOR	LADESTATION
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
ASP CIDEZYME/ENZOL enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	●	
Ecolab Incidin Dry Wipes System (die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○
Isopropylalkohol (IPA; 70 %; allgemeine Desinfektionstücher, die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○
Metrex CaviWipes	Reinigen	○	
Metrex EmPower	Reinigen	○	
schülke mikrozid universal wipes	Reinigen	○	
Clinell Universaltücher	Reinigung/Niedrig	○	○
Metrex CaviWipes1	Reinigung/Niedrig	○	
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	●	○
Vernacare TUFFIE 5 Universalreinigungstücher	Reinigung/Niedrig	○	
WIP'ANIOS EXCEL	Reinigung/Niedrig	○	○
Diversey Accel INTERvention Feuchttücher / Diversey Oxivir Tb Feuchttücher	Niedrig	○	
schülke mikrozid sensitive wipes	Niedrig	○	
Tristel Trio Feuchttuchsystem	Reinigung/hoch	○	○
ASP CIDEX OPA Desinfektionsmittel	Hoch	●	
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoch	●	

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

# GlideScope-Videomonitor, mobiles Stativ, Premium Cart und Netzteil

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	GLIDESCOPE-VIDEOMONITOR	MOBILES STATIV/PREMIUM CART	NETZ-TEIL	BFLEX 2-HALTER	HALTER FÜR AVL VIDEO BATON
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2000</b>
Ecolab Incidin Dry Wipes System (die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○	○		
Isopropylalkohol (IPA; 70 %; allgemeine Desinfektionstücher, die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○	○	○	
Metrex CaviWipes	Reinigen	○	○			
PDI Sani-Cloth Plus keimtötende Feuchttücher	Reinigen					○
Natriumhypochlorit (Bleichmittel; 0,16 %, 1.600 ppm; mit Wischtüchern aufgetragen)	Reinigen		○			
Clinell Universaltücher	Reinigung/Niedrig	○	○	○		
PDI Sani-Cloth Bleach keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	○				
PDI Super Sani-Cloth keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	○	○			
Virox Technologies Accel TB Feuchttücher	Reinigung/Niedrig		○			
Clorox keimtötende Bleichmitteltücher	Niedrig	○				
Diversey Accel INTERvention Feuchttücher / Diversey Oxivir Tb Feuchttücher	Niedrig	○	○			
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Niedrig	○				
Tristel Trio Feuchttuchsystem	Reinigung/hoch	○				

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

## Kabel für GlideScope Core-Monitore

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	QUICK-CONNECT-KABEL	2m QUICK-CONNECT-KABEL	VIDEOKABEL	SMART CABLE
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
ASP CIDEZYME/ ENZOL enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	●	●	●	●
Ecolab Incidin Dry Wipes System (die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○	○	○
Ecolab OptiPro multienzymatisches Reinigungsmittel mit niedriger Schaumbildung	Reinigen	○	○	○	○
HARTMANN Bacillol 30 Tissues	Reinigen	○	○	○	○
Isopropylalkohol (IPA; 70 %; allgemeine Desinfektionstücher, die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○	○	○
Metrex CaviWipes	Reinigen	○	○	○	○
PDI Sani-Cloth Plus keimtötende Feuchttücher	Reinigen	○	○		
schülke perform (pulverförmiges Konzentrat)	Reinigen	○	○	○	○
Clinell Universaltücher	Reinigung/Niedrig	○	○	○	○
Metrex CaviWipes1	Reinigung/Niedrig	○	○	○	○
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	●	●	●	●
PDI Sani-Cloth Prime	Reinigung/Niedrig	○	○	○	○
PDI Super Sani-Cloth keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	○	○	○	○
Vernacare TUFFIE 5 Universalreinigungstücher	Reinigung/Niedrig	○	○	○	○
Anios OPASTER'ANIOS/ Farmec OPASTER	Hoch	●	●	●	●

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	QUICK-CONNECT-KABEL	2m QUICK-CONNECT-KABEL	VIDEOKABEL	SMART CABLE
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
ASP CIDEX OPA Desinfektionsmittel	Hoch	●	●	●	●
Gioperacetic Desinfektionslösung	Hoch	○	○	○	○
STERRAD 50 STERRAD 200S (Kurz- und Standardzyklen) STERRAD 100S (Kurzzyklen für die USA und andere Regionen) STERRAD NX (Standardzyklus) STERRAD 100 NX (Standardzyklus) Alle unter Verwendung von Hydrogenperoxidgas- Plasma	Sterilisation	○ (100)	○ (100)	○ (100)	○ (100)

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

## Kabel für GlideScope-Videomonitor

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	VIDEOKABEL	SMART CABLE	QUICK-CONNECT-KABEL
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>3000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
STERIS PRE-Klenz Gel für den Instrumententransport	Vorreinigung	○	○	
BeliMed Protect enzymatisches Vorbehandlungsschaumspray	Vorreinigung	○ (1500)	○	
Anios Aniosyme XL3 enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	○ (1500)	○	
ASP CIDEZYME/ENZOL enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	○ (1500)	○	●
BeliMed Protect enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	○ (1500)	○	
Certol ProEZ Foam enzymatisches Spray	Reinigen	○ (500)	○ (500)	
Dr. Weigert neodisher MediClean forte	Reinigen	○ (1500)	○	
Ecolab enzymatisches Reinigungsmittel	Reinigen	○	○	
Ecolab Incidin Dry Wipes System (die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○	
Ecolab MetalClean Plus	Reinigen	○ (1500)	○	
Ecolab OptiPro Gel-Vorreiniger für Instrumente	Reinigen	○	○	
Ecolab OptiPro multienzymatisches Reinigungsmittel mit niedriger Schaumbildung	Reinigen	●	○	○
Ecolab Sekusept MultiEnzyme	Reinigen	○	○	
Getinge Renuzyme Schaumspray	Reinigen	○	○	
Isopropylalkohol (IPA; 70 %; allgemeine Desinfektionstücher, die Kompatibilität wurde mit 1 Minute Kontaktzeit beurteilt)	Reinigen	○	○	
Metrex CaviCide	Reinigen	●	●	
Metrex CaviWipes	Reinigen	●	○	○
Metrex EmPower	Reinigen	●	●	
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Reinigen	●	○	○
PDI Sani-Cloth Bleach keimtötende Feuchttücher	Reinigen	● (1500)	●	
PDI Sani-Cloth Active Feuchttücher	Reinigen	●	●	
Pro-Line Solutions EcoZyme	Reinigen	●	●	
Ruhof Prepzyme	Reinigen	○	○	

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	VIDEOKABEL	SMART CABLE	QUICK-CONNECT-KABEL
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>3000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
schülke thermosept ER	Reinigen	○ (1500)	○	
STERIS eSENTIALS Konzentrate	Reinigen	○	○	
STERIS Prolystica 2× enzymatisches Konzentrat zum Voreinweichen und Reinigen	Reinigen	●	●	
STERIS Revital-Ox 2× enzymatisches Reinigungsmittelkonzentrat mit PowerLift Cleaning Technology	Reinigen	○ (1500)	○	
Getinge Tec Wash III	Reinigen	○	○	
WIP'ANIOS PREMIUM	Reinigen	●	●	
B. Braun Meliseptol HBV Tücher	Reinigung/Niedrig	○ (1500)	○	
Clinell Universaltücher	Reinigung/Niedrig	●	○	○
Dr. Schumacher DESCOSEPT SENSITIVE WIPES	Reinigung/Niedrig	○ (1500)	○	
Ecolab Sekusept PLUS	Reinigung/Niedrig	○ (1500)	○	
Metrex CaviWipes1	Reinigung/Niedrig	●	●	
PDI Super Sani-Cloth keimtötende Feuchttücher	Reinigung/Niedrig	○	○	
Vernacare TUFFIE 5 Universalreinigungstücher	Reinigung/Niedrig		○	
Clorox keimtötende Bleichmitteltücher	Niedrig	●	●	
Diversey Accel INTERvention Feuchttücher / Diversey Oxivir Tb Feuchttücher	Niedrig	○ (1500)	○	
PDI Sani-Cloth AF3 keimtötende Feuchttücher	Niedrig	●	●	
PDI Sani-Cloth Bleach keimtötende Feuchttücher	Niedrig	● (1500)	●	
Tristel Trio Feuchttuchsystem	Reinigung/hoch	●	●	
Anios OPASTER'ANIOS/Farmec OPASTER	Hoch	●	●	
ASP CIDEX Activated Dialdehyde Solution (ADS)	Hoch	●		
ASP CIDEX OPA Desinfektionsmittel	Hoch	●	●	
Cantel (MEDIVATORS) automatisierte Endoskopaufbereiter: CER Optima 1 & 2 DSD-201 SSD-102	Hoch	● (100)		
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide OPA/28	Hoch	●	●	
Cantel (MEDIVATORS) Rapicide PA 30°C in Cantel Advantage Plus Endoskopaufbereitungssystem	Hoch	● (100)	● (100)	
Metrex Metricide 28	Hoch	●		

- Wirksam und kompatibel
- Kompatibel

PRODUKT	DESINFEKTIONS-STUFE	VIDEOKABEL	SMART CABLE	QUICK-CONNECT-KABEL
<b>Standardkompatibilität (Zyklen)</b>		<b>3000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Metrex MetriCide OPA Plus	Hoch	●	●	
STERIS Resert XL HLD	Hoch	●	○	
STERIS Revital-Ox Resert XL HLD	Hoch	●	○	
STERIS Revital-Ox Resert XL HLD / Chemosterilans	Hoch	●	○	
Sultan Healthcare Sporox II	Hoch	●	○	
Anios Anioxyde 1000 hochwirksames Desinfektionsmittel und Kaltsterilisationsmittel	Hoch/Sterilisation	○	○	
STERIS S40 oder S20 in einem der folgenden Systeme: System 1 E System 1 System 1 Express System 1 Plus	Hoch/Sterilisation	● (600)	● (750)	
Ethylenoxid (EO)	Sterilisation	● (100)		
STERIS V-PRO Niedertemperatur-Sterilisationssysteme: V-PRO 1 V-PRO 1 Plus V-PRO maX V-PRO 60 Alle unter Verwendung von STERIS VAPROX HC	Sterilisation	● (125)	● (100)	
STERRAD 50 STERRAD 200S (Kurz- und Standardzyklen) STERRAD 100S (Kurzzyklen für die USA und andere Regionen) STERRAD NX (Standardzyklus) STERRAD 100 NX (Standardzyklus) Alle unter Verwendung von Hydrogenperoxidgas-Plasma	Sterilisation	● (125)	● (100)	

# Glossar

Die nachfolgende Tabelle enthält Definitionen für die in diesem Dokument oder auf dem Produkt verwendeten Fachbegriffe. Eine vollständige Liste der bei diesem und anderen Verathon-Produkten verwendeten Vorsichtshinweise, Warnhinweise und Informationssymbole finden Sie im Verathon-Symbolverzeichnis unter [verathon.com/service-and-support/symbols](http://verathon.com/service-and-support/symbols).

BEGRIFF	DEFINITION
AER	Automatisierter Endoskopaufbereiter
Aufbereitung	Vorbereitung einer wiederverwendbaren Komponente für den nächsten Gebrauch. Die Aufbereitung umfasst die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation wie erforderlich.
C	Celsius
CFR	Code of Federal Regulations (USA, US-amerikanisches Bundesgesetzbuch)
cm	Zentimeter
CSA	Kanadische Normungsorganisation (engl. Canadian Standards Association)
DL	Direkte Laryngoskopie
F	Fahrenheit
g	Gramm
HDMI	High Definition Multimedia Interface
hPa	Hektopascal
in	Inch (Zoll)
IPA	Isopropylalkohol
ISO	International Standards Organization (ISO, Internationale Organisation für Normung)
kPa	Kilopascal
l	Liter
lbs	Pfund
m	Meter
Maßgebliche Leistung	Die Systemleistung, die nötig ist, um frei von unakzeptablen Risiken zu bleiben
MDD	Medizinprodukterichtlinie (engl. Medical Device Directive)
ml	Milliliter
mm	Millimeter
mmHg	Millimeter Quecksilbersäule
MSDS	Materialsicherheitsdatenblatt
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (US-amerikanische Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)
psia	Pounds per square inch absolute (Absolutdruck)
RH	Relative Luftfeuchtigkeit
SDS	Natriumdodecylsulfat



**verathon**